


INFORMATIONS GENERALES				
Nom du site	Pont des Pauvres			
Cours d'eau	Canal de la Reunion			
Commune	Narbonne	Département	Aude (11)	
Route	Pont des Pauvres	Coordonnées GPS	N 43.141545° E 3.046867°	
Propriétaire de l'ouvrage n°1 Mairie de Narbonne		autorisation travaux	Obtenue	
		contact	M Maire	
		téléphone	04 68 90 30 30	
	email	mairie@mairie-narbonne.fr		
	adresse	Place de l'Hôtel-de-Ville, BP 823 11 108 Narbonne cedex		
Propriétaire de l'ouvrage n°2 -		autorisation travaux	-	
		contact	-	
		téléphone	-	
	email	-		
	adresse	-		
Maitre d'ouvrage SMMAR		autorisation travaux	Sans objet	
		contact	Philippe CLUZEL	
		portable	06 78 03 23 64	
	email	philippe.cluzel@smmar.fr		
	adresse	SMMAR – EPTB du Bassin de l'Aude		
Responsable démarches administratives et installateur Ceneau	contact		Marion LIVET	
	tel	04 67 04 16 43	portable	06 78 87 33 63
	email	m.livet@ceneau.com		
	adresse	265, avenue de l'industrie, 34 820 Teyran		
PRESENTATION DES TRAVAUX				
Présentation des travaux	- Mise en place d'un logger + sonde dans un tube en acier crépiné ; - Alimentation : pile lithium; - Transmission: GSM/GPRS/4G; - Mise en place d'une échelle limnimétrique de 1.5m.			
Schéma d'implantation et/ou photos	Oui	Cf. fiche station + Photos complémentaires disponibles à demander		
Demande de raccordements	Non			
DT	sans objet			
DICT	sans objet			
LOCALISATION STATION				
				

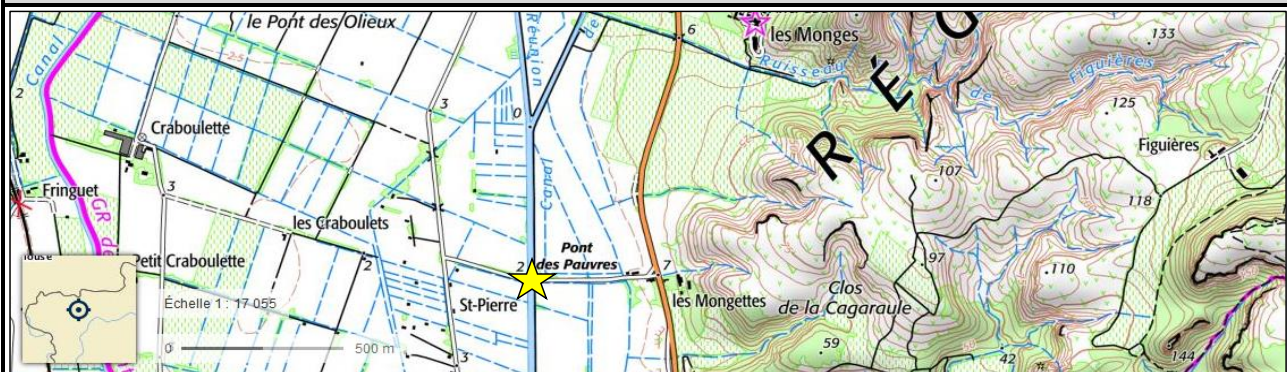


FICHE STATION - DOSSIER RECOLEMENT
PC1911-01221 - Volet 2 - Tranche 2 : Instrumentation en rivières, sur prises
d'eau et mise en place de pluviomètres

11/06/2020

LOCALISATION		
Nom de la station	Pont des Pauvres	
Cours d'eau	Canal de la Reunion	
Route	Pont des Pauvres	
Commune	Narbonne	
Département	Aude (11)	
Coordonnées GPS	N 43.141545° E 3.046867°	
Emplacement station	-	
CENTRALE D'ACQUISITION		
Centrale d'acquisition	Ecolog 1000, OTT	
Numéro de série	EL1K-000683	
MODEM		
Modem intégré à la centrale	Modem GPRS/4G interne à l'Ecolog 1000, OTT	
Numéro de ligne	KPN Multiopérateur +3197021191316 / apn : matooma.m2m	
Qualité signal	non mesurée	
CAPTEURS		
Capteur n°1	Sonde Ecolog 1000, OTT (Signal RS485 Pleine échelle : 0-10m)	
Numéro de série	EL1K-000683	
ECHELLES LIMNIMETRIQUE		
Echelle limnimétrique	Echelle limnimétrique de 1.5m	
Calage du zéro en mNGF	Zéro échelle : -0.16mNGF Clou d'arpentage de référence : 1.96mNGF	
Support de l'échelle	Support en fer plat Inox	
ALIMENTATION		
Alimentation primaire	Batterie Lithium 3.6V 26Ah	
Régulateur	-	
Alimentation secondaire	-	
PROTECTIONS		
Mise à la terre	-	
Qualité terre ohm	-	
protection court circuit TBT	centrale acquisition	-
	modem	-
	circuit général	-
protection court circuit BT	régulateur	-
	autres circuits	-
	autres circuits	-
	autres circuits	-
protection foudre	alimentation primaire	-
	capteur 1	-
AUTRES		
Chauffage armoire	sans objet	

IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS

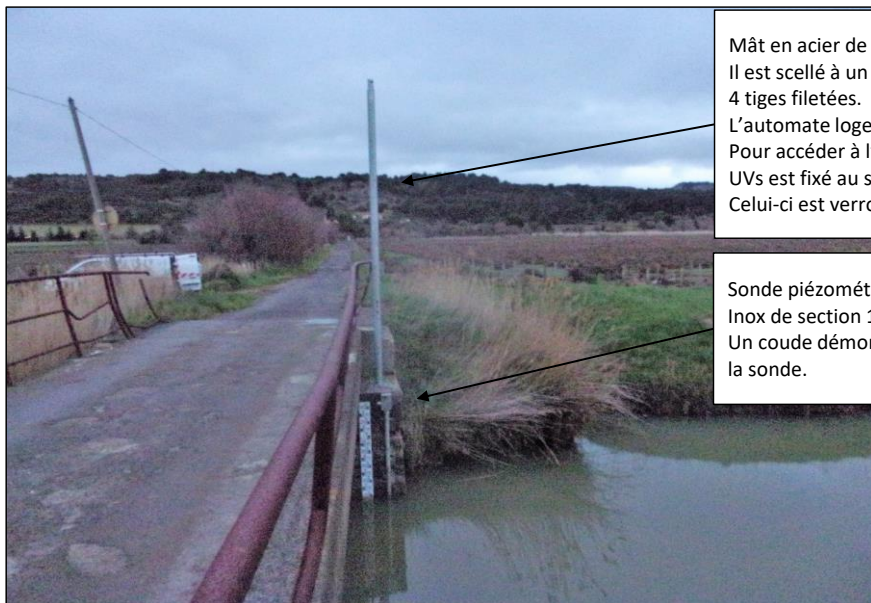

Mât en acier de 4m de haut et de DN90mm.
 Il est scellé à un massif béton au sommet de la digue avec 4 tiges filetées.
 L'automate loge à l'intérieur.
 Pour accéder à l'appareil, un obturateur PVC résistant aux UVs est fixé au sommet du tube.
 Celui-ci est verrouillé par un boulon.

Sonde piézométrique logée dans un puits de mesure en Inox de section 1pouce 1/2 et crépiné.
 Un coude démontable est en place pour faciliter l'accès à la sonde.

Echelle limnimétrique de 1.5m fixée dans un support en fer plat Inox.
 Le zéro de l'échelle limnimétrique est à la cote : -0.16mNGF.



Clou d'arpentage de référence :
 1.96mNGF

Appareil de mesure en place dans
 le puits de mesure

